

Auftragsformular Atelier IdO-Hörsysteme

Absender/Kundennummer

Angaben zum Kunden

Kommission

Ohrmulde/Gehörgang

- Druckgefährdet/verknorpelt
 Weich/nachgiebig

Ansprechpartner/Hörakustiker

Frau Herr

Rückruf erwünscht

Tel.-Nr. _____

Audiogramm

Bitte generell angeben und komplettes Audiogramm beifügen

Frequenz in Hz 250 500 1000 2000 3000 4000

HV in dB rechts

--	--	--	--	--	--

HV in dB links

--	--	--	--	--	--

(Erstversorgung)

Modell/Typ

1 Pflichtangaben

Typ	Seite	Tech Level	Batterie	Verstärkung (dB)	Poti / VC	Taster separat	Taster integ.	T-Spule	Wireless	Direktional	Bluetooth	DIC	Mini-CIC	CIC	Kleiner Gehörgang	Gehörgang	Halbconcha	Concha kleine Cymba	Concha große Cymba	
Icon Precise	R L	16	10	50	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Icon	R L	16		50	55	65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ilea	R L	16	312	50	55	65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ida BT	R L	16		-	55	65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Optionen, die nicht angekreuzt sind, werden nicht gebaut.
 = Standard = Optional = nicht erhältlich

Vent in mm

Pflichtangaben

EquiVent (AEV) YO-Vent¹⁾ D-Vent (ab 1,6 mm) Runder Vent

	Ohne	1,0	1,3	1,6	2,0	2,5	3,0	Max
Rechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Links	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ComforMed (AOV) Audiogramm ist zwingend erforderlich!

Oberfläche

3

Standard: ComforMed andere Beschichtung _____

Zusätzliche Schalenoptionen

Wachsen: Standard Option: x 0,5 x 1 x 2

Ventstufe Gehörgangsende konisch Zugfaden

Zusatzlaserung _____

Sonderwünsche


Farben

2

Schale _____

Faceplate _____

Gehörgangslänge



Lang (Standard bei Icon)

Mittel (Standard bei Ilea, Ida)

Kurz

Maximal nutzbare Länge

Garantieerlängerung

(zur Standardgarantie für IdO-Hörsysteme)


+ 12 Monate

+ 24 Monate

+ 36 Monate

+ 48 Monate

Erläuterungen zum Auftragsformular für Atelier IdO-Hörsysteme

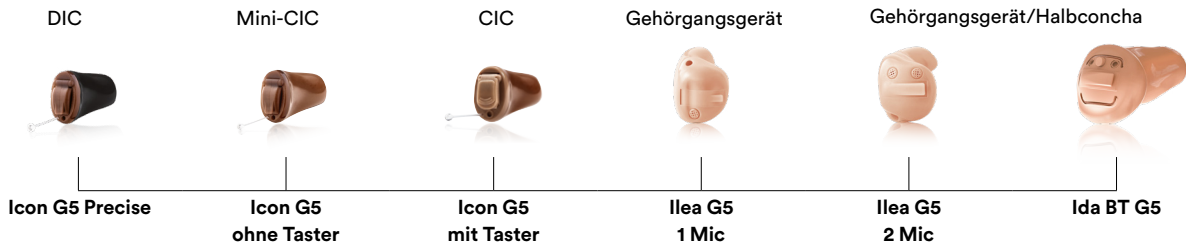


Optionen für Farben

01

Schalen	Typ					
	Icon G5 Precise	Icon G5	Icon G5 mit Taster	Ilea G5 1 Mic	Ilea G5 2 Mic	Ida BT G5
Black Carbon-Look*						
Golden Carbon-Look*						
Fire 'n Flame-Look ¹⁾ *						
Fire 'n Flame-Look transparent ¹⁾ *						
Olivenholz*						
Vergoldung ²⁾ *						
Weiß (WH)						
Schwarz (BK)						
Tan (TN)						
Braun (BN)						
Rot (RD)						
Blau (BL)						
Transparent (CL)						
Orange (CO)						
Zitrus (CY)						
Smaragd (CG)						
Purpur (CV)						
Faceplate						
Beige (BG)						
Tan (TN)						
Mokka (MC)						
Braun (BN)						
Dunkelbraun (DB)						
Schwarz (BLK)						

Standard

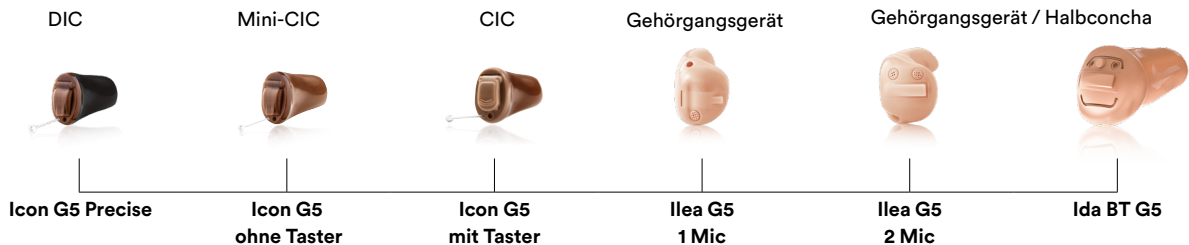

02

Optionen für Beschichtungen und Oberflächen

Beschichtungen	Typ			
	Icon G5 Precise	Icon G5	Ilea G5	Ida BT G5
ComforClean	○	○	○	○
ComforMed	●	●	●	●
Vergoldung ²⁾	–	○	○	–
Verglasung	○	○	○	○
Vent-Optionen³⁾				
EquiVent	○	○	○	○
YO-Vent	○	○	○	○
D-Vent	●	●	●	●
Runder Vent	○	○	○	○
ComforVent	○	○	○	○

03

Typ	Mikrofon	Bedienoptionen		Zubehör	Konnektivität		
		Bedienelemente	Lautstärkeregelung	Smart Key	Wireless-funktionalität	Telefonspule	Bluetooth
Icon Precise	1	–	Optional ⁴⁾	Optional	Standard	–	–
Icon	1	Optional: Taster			Optional	–	–
Ilea	1 - 2	Optional: Taster, Poti	Optional		Optional	Optional	–
Ida BT	2	Standard: Taster			Standard	–	Standard

Erläuterungen

- Serienausstattung
- Optional möglich
- Nicht lieferbar

¹⁾ Fire 'n Flame-Look wird standardmäßig auf einer weißen Schale aufgebracht.

Bei transparenter Schale lässt die Oberfläche Blick auf die Elektronik zu.

²⁾ Vergoldung nicht möglich bei IdOs mit Wireless-Funktionalität.

³⁾ Für Sonderbauten bitte Rücksprache mit technischem Kundenservice.

⁴⁾ Bei Icons ohne Taster per Smart Key oder Audio Service App.

* Beschichtung darf nicht beschädigt werden durch z.B. manuelles Bearbeiten.

Microsafe: Mikrofonfilter serienmäßig bei Ida Bt und Icon mit integriertem Taster.

Batterie-Verlierschutz und Wechselstift: serienmäßig bei Icon.

Zugfaden: serienmäßig bei Icon und Ilea, optional bei Ida BT.

Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage.

Optionen können kostenpflichtig sein.

Veredelte Schalen dürfen nicht geätzt werden.